

细胞遗传质量鉴定检测

Cell Line Authentication Service

STR 基因型检测报告

检测单位：睿必特生物科技（上海）有限公司

检品名称：细胞系

报告日期：2024-10-28



报告说明

1. 本报告只对送检的来样负责。
2. 检验报告上的检验结果和检验单位名称，未经同意不得用于广告、评优及商业宣传。
3. 对本报告有异议， 请于收到报告之日起十五日内以书面方式提出， 逾期不予以受理。
4. 对纸质检验报告涂改、增删，或未加盖检验单位印章的复印件均无效。



样 品 信 息

样品编号：

客户样本编号	公司编号
Jurkat	202410284-02

样品数量： 1

样品性状： 细胞系

检测项目： STR

检测方法： 用 Axygen的基因组抽提试剂盒提取 DNA，采用 21- STR 扩增方案扩增，
在 ABI 3730XL 型遗传分析仪上对 STR 位点和性别基因 Amelogenin 进行
检测。



检测结果

(一) 检验基本情况

公司编号	多等位基因	匹配细胞系	细胞库	EV 值	匹配说明
202410284-02	无	Jurkat E6-1	EXPASY	1.0	完全匹配

样本基因型检验结果

- 多等位基因指三等位及以上基因现象。
- 本次检测各细胞分型结果良好。

(二) 各样本描述

- 202410284-02：该株细胞 DNA 分型在细胞系检索中找到完全匹配的细胞系，EXPASY 数据库显示细胞名为 Jurkat E6-1，细胞号对应CVCL_0367。本次检测在该细胞系中未发现多等位基因。

备注：待测细胞系与收录于 ATCC, DSMZ, JCRB 和 RIKEN 数据库的细胞系 STR 数据进行比对，未收录于以上细胞库的细胞系将无法匹配。

Accession #	Name	性	NP Markers	Stutter	Ampl	CSF1PO	D151958	D213538	D35358	D55043	D75828	D85178	D13528	D135378	D185528	D195438	D215118	PE04	Penta D	Penta E	TH05	TP03	vWA		
NA	Query	NA	NA	NA	XY	16.12	16.96.2	16.22	15.17	8	11	8.12	13.14	12.23	8.12	11	13.21	14.15.2	21.3.35	20.21	11.12	16.12	6.8.2	8.10	18
CVCL_0367	Jurkat E6-1	TT	190.0	0%	XY	11.12		11.23	15.17	8		8.12	13.14		8.12	11	12.21	14.15.2	21.2.35	20.21	11.13	10.12	6.8.3	8.10	18



(三) 样本分型结果

细胞 202410284-02 的 STR 位点和 Amelogenin 位点的基因分型结果						
Loci	送检细胞 STR 信息			细胞库细胞 STR 信息		
	送检细胞名：Jurkat			细胞库细胞名：Jurkat E6-1		
	Allele1	Allele2	Allele3	Allele1	Allele2	Allele3
D3S1358	15	17		15	17	
vWA	18			18		
D7S820	8	12		8	12	
CSF1PO	11	12		11	12	
Penta E	10	12		10	12	
D8S1179	13	14		13	14	
D21S11	31.2	33.2		31.2	33.2	
D16S539	11			11		
D2S1338	19	23		19	23	
Penta D	11	13		11	13	
D19S433	14	15.2		14	15.2	
TH01	6	9.3		6	9.3	
D13S317	8	12		8	12	
TPOX	8	10		8	10	
D18S51	13	21		13	21	
D6S1043	11			11		
AMEL	X	Y		X	Y	
D1S1656	16	16.3		16	16.3	
D5S818	9			9		
D12S391	22	23		22		
FGA	20	21		20	21	



其他说明

(一) 分型方案及位点分布

	方案 1	方案 2	方案 3	方案 4
1	D3S1358	D8S1179	D19S433	AMEL
2	VWA	D21S11	TH01	D1S1656
3	D7S820	D16S539	D13S317	D5S818
4	CSF1PO	D2S1338	TPOX	D12S391
5	PENTAE	PENTAD	D18S51	FGA
6			D6S1043	

实验方案及位点

(二) STR 数据库比对

本公司采用 DSMZ tools 进行细胞系比对，其中包含来自于 ATCC, DSMZ, JCRB 和 RIKEN 数据库的 2455 个细胞系 STR 数据。如果待检测细胞未收录于以上细胞库或这是自行建立的新细胞系将无法进行比对，用户需根据细胞分型结果自行与其他数据库进行比对。


签发日期：2024-10-30



Sample Name


Jurkat

D3S1358 vWA D7S820 CSF1PO Penta E

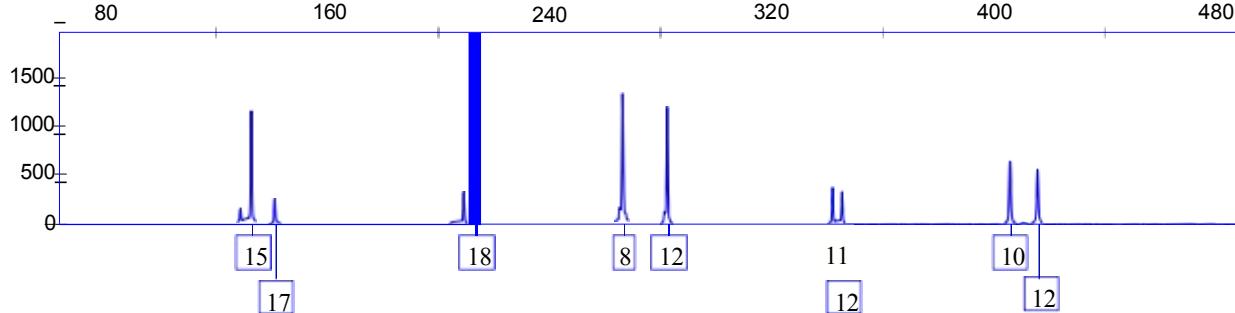


Jurkat

D8S1179 D21S11 D16S539 D2S1338 Penta D

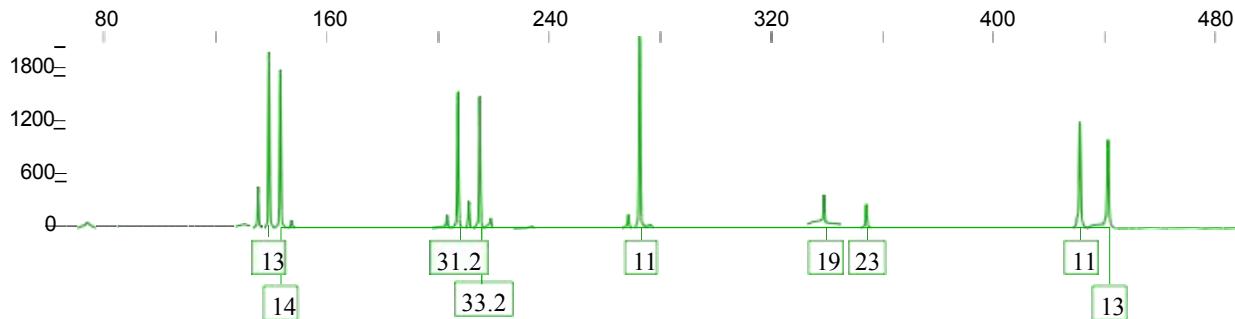

Jurkat

D19S433 TH01 D13S317 TPOX D18S51 D6S1043

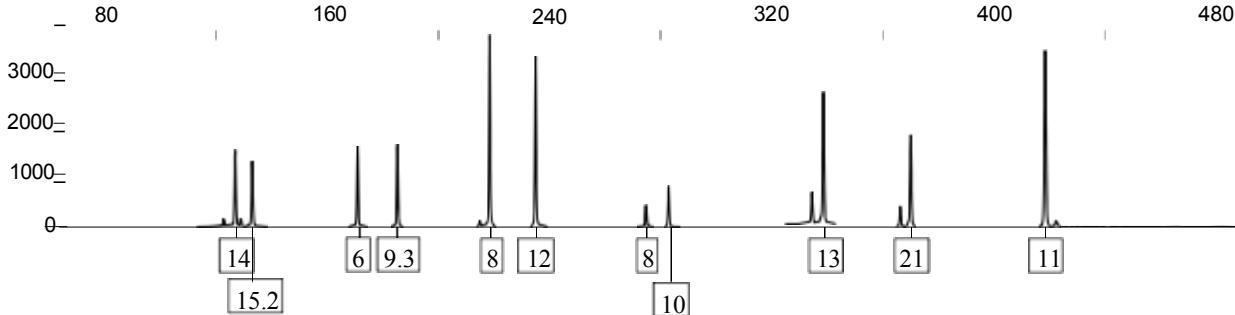

Jurkat

AM D1S1656 D5S818 D12S391 FGA

